

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年11月29日
Date of Application:


出願番号 特願2002-347709
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2002-347709]

出願人 三洋電機株式会社
Applicant(s): 三洋電機バイオメディカ株式会社

2003年 7月11日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康

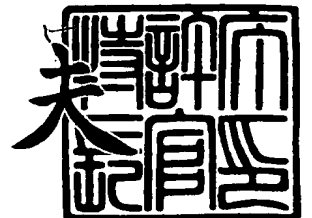

出証番号 出証特2003-3056888

【書類名】 特許願

【整理番号】 YAB02-0079

【提出日】 平成14年11月29日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F25B 7/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機バイオ
メディカ株式会社内

【氏名】 ▲高▼杉 勝治

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機バイオ
メディカ株式会社内

【氏名】 玉置 裕一

【特許出願人】

【識別番号】 000001889

【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 302010448

【氏名又は名称】 三洋電機バイオメディカ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100062225

【弁理士】

【氏名又は名称】 秋元 輝雄

【電話番号】 03-3475-1501

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001580

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9004600

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 二元冷凍装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 筐体内に収納された低温側冷媒回路の冷媒凝縮部と高温側冷媒回路の冷媒蒸発部とが併設され、前記低温側冷媒回路の前記冷媒凝縮部が前記高温側冷媒回路の前記冷媒蒸発部で発生する冷熱により冷却されて前記低温側冷媒回路の冷媒が前記冷媒凝縮部において凝縮する二元冷凍装置において、前記高温側冷媒回路の低圧側に減圧手段を介して接続された高温側冷媒タンクと前記低温側冷媒回路の低圧側に減圧手段を介して接続された低温側冷媒タンクとを備え、一方の前記冷媒タンクは前記筐体内に設置され、他方の前記冷媒タンクは前記筐体背面に添設されたことを特徴とする二元冷凍装置。

【請求項 2】 前記筐体背面に添設された高温側または低温側の前記冷媒タンクは複数本に分割して添設されたことを特徴とする請求項 1 記載の二元冷凍装置。

【請求項 3】 前記筐体内に前記低温側冷媒タンクが設置され、前記筐体背面に前記高温側冷媒タンクが添設されたことを特徴とする請求項 1 または 2 記載の二元冷凍装置。

【請求項 4】 前記筐体背面に添設された前記冷媒タンクより後端部が後方に位置する壁当部材が、前記筐体背面に添設されたことを特徴とする請求項 1 ～ 3 何れかに記載の二元冷凍装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、高温側冷媒回路と低温側冷媒回路とを備えて構成される二元冷凍装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

この種の冷凍装置としては、例えば図 4 に示したように圧縮機 1、凝縮器 2、減圧弁 3、蒸発器 4 を直列に連結して構成される高温側冷媒回路 H の、冷媒蒸発

部である蒸発器 4 と、圧縮機 11、凝縮器 12、減圧弁 13、蒸発器 14 を直列に連結して構成される低温側冷媒回路 L の、冷媒凝縮部である凝縮器 12 とを併設し、蒸発器 4 で蒸発する高温側冷媒回路 H の冷媒の気化熱により、低温側冷媒回路 L の冷媒を凝縮器 12 において冷却して凝縮させ、その凝縮した低温側冷媒回路 L の冷媒を蒸発器 14 において蒸発させ、高温側冷媒回路 H の蒸発器 4 で得られる低温より一段と低い低温を低温側冷媒回路 L の蒸発器 14 で得るように構成した二元冷凍装置 100X が公知である（例えば、特許文献 1 参照。）。

【0003】

また、低温側冷媒回路 L においては、破線で示したようにその低圧側、すなわち圧縮機 11 の冷媒吸込側に、減圧手段であるキャピラリーチューブ 15 が介在する接続管 16 を介して冷媒タンク 17 を接続する構成も公知である（例えば、特許文献 2 参照。）。

【0004】

そして、従来の二元冷凍装置 100X においては、高温側冷媒回路 H と低温側冷媒回路 L を構成する全ての機器が一般的な建家における戸口を通して研究室や、バクテリア、血液成分、骨髓、臨床試薬、菌糸類、各種細胞、精子、受精卵、核酸などを冷却保存しておくための保管室などに簡単に搬入することができるように、例えば幅が 770 mm、奥行 900 mm、高さ 2000 mm 程度の大きさに形成された筐体 50 の機器収納部に収納されている。

【0005】

なお、図 4 に示したように冷媒同士が熱交換可能に高温側冷媒回路 H の蒸発器 4 と低温側冷媒回路 L の凝縮器 12 とが併設されて一体化された熱交換機器は、カスケードコンデンサと称されている。

【0006】

【特許文献 1】

特開 2001-91074（図 1）

【特許文献 2】

特開 2001-40340（図 1）

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

上記従来の二元冷凍装置 100X においては、高温側冷媒回路 H の蒸発器 4 で -40°C 程度の低温を得ようとして、高温側冷媒回路 H に 1 気圧における沸点が例えば -40°C 程度の非フロン系冷媒、例えば R407D (R32 (ジフルオロメタン: CH_2F_2) 15 質量%、R125 (ペンタフルオロエタン: CHF_2CF_3) 15 質量%、R134a (テトラフルオロエタン: CH_2FCF_3) 70 質量%) とペンタンとの混合冷媒 (質量比で 94:6) を所定量封入すると、圧縮機 1 がシリンダ内でピストンを往復動作させて冷媒を圧縮するレシプロ型のとときには停止平衡圧 (冷媒吸込側圧力と冷媒吐出側圧力とが同圧となったときの圧力) は外気が 35°C のときで 734 kPa にも達し、それを圧縮機 1 で圧縮すると冷媒吐出側のピーク圧力は 2.7 MPa にも達するので、圧縮機 1 はモータのトルクが十分大きくないと始動することができない (蒸発器の温度が十分に低下した状態、すなわち冷媒が膨張弁を順調に通過するようになると、冷媒の搬送抵抗は大きく低下するので、圧縮機は小さいトルクでも回転する)。

【0008】

そのため、従来の二元冷凍装置 100X においては、圧縮機 1 に大型モータを備えた圧縮機を使用していたが、①電力消費量が多い、②騒音も大きい、と云った不都合があったため、例えば図 3 に示したように高温側冷媒回路 H の低圧側にキャピラリーチューブ 5 などの減圧手段を介して冷媒タンク 7 を接続し、高温側冷媒回路 H の停止平衡圧を下げて圧縮機 1 がトルクの小さい小型モータを備えた圧縮機であっても始動できるようにする必要があった。

【0009】

しかし、高温側冷媒回路 H の低圧側と低温側冷媒回路 L の低圧側それぞれに減圧手段を介して接続する冷媒タンク 7、17 を設けると、冷媒回路 H、L を構成する全ての機器を従来の大きさの筐体 50 には収納することができなくなる。一方、冷媒回路 H、L を構成する全ての機器が収納可能に筐体 50 を大型化すると、一般的な建家における戸口を通して研究室や、バクテリア、血液成分、骨髓、臨床試薬、菌糸類、各種細胞、精子、受精卵、核酸などを冷却保存しておくための保管室などに搬入することができなくなると云った問題点がある。

【0010】

したがって、電力消費量と騒音の削減が可能に、高温側冷媒回路、低温側冷媒回路それぞれの低圧側にキャピラリーチューブなどの減圧手段を介して冷媒タンクを接続し、各冷媒回路における停止平衡圧を下げて圧縮機がトルクの小さい小型モータを備えた圧縮機であっても始動できるように構成した二元冷凍装置が、従来と同程度の大きさの筐体を使用して製造することができるようにする必要がある、それが解決すべき課題となっていた。

【0011】

【課題を解決するための手段】

本発明は上記従来技術の課題を解決するため、筐体内に収納された低温側冷媒回路の冷媒凝縮部と高温側冷媒回路の冷媒蒸発部とが併設され、前記低温側冷媒回路の前記冷媒凝縮部が前記高温側冷媒回路の前記冷媒蒸発部で発生する冷熱により冷却されて前記低温側冷媒回路の冷媒が前記冷媒凝縮部において凝縮する二元冷凍装置において、前記高温側冷媒回路の低圧側に減圧手段を介して接続した高温側冷媒タンクと前記低温側冷媒回路の低圧側に減圧手段を介して接続した低温側冷媒タンクとを備え、一方の前記冷媒タンクは前記筐体内に設置し、他方の前記冷媒タンクは前記筐体背面に添設するようにした第1の構成の二元冷凍装置と、

【0012】

前記第1の構成の二元冷凍装置において、前記筐体背面に添設する高温側または低温側の前記冷媒タンクは複数本に分割して添設するようにした第2の構成の二元冷凍装置と、

【0013】

前記第1または第2の構成の二元冷凍装置において、前記筐体内に前記低温側冷媒タンクを設置し、前記筐体背面に前記高温側冷媒タンクを添設するようにした第3の構成の二元冷凍装置と、

【0014】

前記第1～第3何れかの構成の二元冷凍装置において、前記筐体背面に添設した前記冷媒タンクより後端部が後方に位置する壁当部材を、前記筐体背面に添設

するようにした第4の構成の二元冷凍装置と、
を提供するものである。

【0015】

【発明の実施の形態】

以下、図1～図3に基づいて本発明の一実施形態を詳細に説明する。なお、理解を容易にするため、これらの図においても前記図4において説明した部分と同様の機能を有する部分には、同一の符号を付した。

【0016】

本発明の二元冷凍装置100においては、図3に例示した二元冷凍回路を構成する機器の内、高温側冷媒回路Hの冷媒タンク7以外の機器が従来と同じ大きさ、すなわち幅が770mm、奥行900mm、高さ2000mm程度の大きさに形成された筐体50の下部側に設けられた機器収納部51に収納設置され、冷媒タンク7が筐体50の背面に添設されている。

【0017】

なお、図1、図2に例示した二元冷凍装置100においては、冷媒タンク7は2本に分割されて添設される構成であるため、停止平衡圧を下げるために筐体50の背面に添設した2個の壁当部材52と、下方に装着されている消音カバー53との間に必要な内容積、例えば2本の冷媒タンク7の内容積と、キャピラリーチューブ5から冷媒タンク7に至る間の接続管6の内容積との和が高温側冷媒回路Hの全内容積の、例えば30～75%程度になるように設定しても、各冷媒タンク7の径を小さくすることができるので、冷媒タンク7を壁当部材52より後方に突出しないように設置することができる。

【0018】

2本の冷媒タンク7は、筐体50の背面左側（背面側から見て）部分の上下に配置した2個のヒンジ54により水平面内で回動可能に取り付けられた板状のタンク搭載部材55に適宜の方法、例えば溶接により固定されて、2本の冷媒タンク7は筐体50の背面左側部分において、左方向に回動可能に添設されている。

【0019】

また、タンク搭載部材55の左右両側には、L字状に起立した止め金具56が

設けられている。そして、ヒンジ 5 4 が取り付けられていない側の止め金具 5 6 には螺子 5 7 を備えた回動防止手段 5 8 が取り付けられ、螺子 5 7 を筐体 5 0 の背面に螺設した螺子孔 5 9 に嵌り込むことにより、回動防止手段 5 8 によってタンク搭載部材 5 5 を筐体 5 0 に回動しないように固定でき、それにより冷媒タンク 7 を筐体 5 0 の背面に確実に添設することができる。

【0 0 2 0】

上記のように筐体 5 0 の背面に添設された 2 本の冷媒タンク 7 は、冷媒タンク 7 側に直径が 5 ～ 1 0 c m 程度のループ 6 L を備えた接続管 6 により高温側冷媒回路 H の低圧側に接続されるので、例えば鉄（ステンレス鋼を含む）によって形成した冷媒タンク 7 の下端と筐体 5 0 の背面との間を連結する接続管 6 を、例えば外径 6 . 3 5 m m 程度の銅パイプにより形成しても、冷媒タンク 7 を回動する回数が 1 0 回程度であれば接続管 6 が破損することはない。

【0 0 2 1】

そして、螺子孔 5 9 から回動防止手段 5 8 の螺子 5 7 を外してタンク搭載部材 5 5 をヒンジ 5 4 により回動し、タンク搭載部材 5 5 に固定した冷媒タンク 7 を回動するのは、筐体 5 0 の背面に取り付けた背面扉 6 0 を開け、機器収納部 5 1 に収納した機器を修理するときに限られるので、背面扉 6 0 を開ける回数は一般的には 1、2 度あるか／ないかであり、5 回を超えることは殆どない。したがって、銅パイプなどによって形成される接続管 6 は、1 0 度回動しても破損しなければ十分実用に耐え得る装置であると云える。

【0 0 2 2】

なお、バクテリア、血液成分、骨髓、臨床試薬、菌糸類、各種細胞、精子、受精卵、核酸などを冷却保存するために機器収納部 5 1 の上方に設けられた被冷却物収納部 6 1 は、例えばヒンジにより取り付けられた片開きの扉 6 2 によって開閉される。

【0 0 2 3】

上記構成の本発明の二元冷凍装置 1 0 0 においては、高温側冷媒回路 H の冷媒タンク 7 が従来と同じ大きさ、すなわち幅が 7 7 0 m m、奥行 9 0 0 m m、高さ 2 0 0 0 m m 程度の大きさに形成された筐体 5 0 の背面に添設され、二元冷凍回

路を構成するそれ以外の機器は機器収納部 5 1 に収納されているので、一般的な建家における戸口を通して研究室や、バクテリア、血液成分、骨髄、臨床試薬、菌糸類、各種細胞、精子、受精卵、核酸などを冷却保存しておくための保管室などに簡単に搬入することができる。

【 0 0 2 4 】

また、筐体 5 0 の背面に冷媒タンク 7 を添設してあるが、冷媒タンク 7 は壁当部材 5 2 より後方に突出していないので、壁際に設置するときには二元冷凍装置 1 0 0 を壁に押し付けても、冷媒タンク 7 が壁に当たって破損することはない。したがって、二元冷凍装置 1 0 0 の設置には細心の注意を払う必要がなく、速やかな設置が可能になる。

【 0 0 2 5 】

なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではないので、特許請求の範囲に記載の趣旨から逸脱しない範囲で各種の変形実施が可能である。

【 0 0 2 6 】

例えば、機器収納部 5 1 には高温側冷媒回路 H の低圧部に接続する冷媒タンク 7 を収納し、筐体 5 0 の背面には低温側冷媒回路 L の低圧部に接続する冷媒タンク 1 7 を添設するように構成することも可能である。

【 0 0 2 7 】

また、タンク搭載部材 5 5 に搭載する冷媒タンク 7 (1 7) は、金属製バンドなどにより固定することも可能である。

【 0 0 2 8 】

また、筐体 5 0 の背面に添設した冷媒タンク 7 (1 7) に接続する接続管 6 は筐体 5 0 の内側に設ける部分と、筐体 5 0 の外側に設ける部分とに分割し、それぞれを筐体 5 0 の裏板に取り付けた螺子付き連結手段などに袋ナットなどにより連結して 2 本の接続管 6 同士を連通させるように構成し、冷媒タンク 7 (1 7) を回動するときには、筐体 5 0 の外側にあつて冷媒タンク 7 (1 7) に連結されている接続管 6 を螺子付き連結手段などから外して、冷媒タンク 7 (1 7) を筐体 5 0 の外側に位置する部分の接続管 6 と回動するように構成しても良い。

【 0 0 2 9 】

また、壁当部材 52 には、壁などに固定するための螺子などからなる適宜の固定手段を設け、地震発生時にも二元冷凍装置 100 が転倒しないように構成することも可能である。

【0030】

また、筐体 50 に断熱に支障がない程度の窪みを設けて設置することなども可能である。

【0031】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、電力消費量と騒音の削減が可能に、高温側冷媒回路、低温側冷媒回路それぞれの低圧側にキャピラリーチューブなどの減圧手段を介して冷媒タンクを接続し、各冷媒回路における停止平衡圧を下げて圧縮機がトルクの小さい小型モータを備えた圧縮機であっても始動できるように構成した二元冷凍装置が、従来と同程度の大きさの筐体を使用して製造することができるようになったので、一般的な建家における戸口を通して研究室や、バクテリア、血液成分、骨髓、臨床試薬、菌糸類、各種細胞、精子、受精卵、核酸などを冷却保存しておくための保管室などに簡単に搬入することができる。

【0032】

また、筐体背面に添設する高温側または低温側の冷媒タンクは複数本に分割して添設するようにした発明によれば、停止平衡圧を下げるために筐体背面に添設する冷媒タンクの総内容積を大きくしても、各冷媒タンクの径を小さくすることができるので、前後方向の寸法を小さくすることができる。

【0033】

また、筐体内に低温側冷媒タンクを設置し、筐体背面に高温側冷媒タンクを添設するようにした発明によれば、低温側冷媒回路は従来と全く同様に配置し、高温側冷媒回路も従来と殆ど同様に配置し、筐体背面に設けた冷媒タンクと筐体内に配置した高温側冷媒回路の低圧側とを筐体内に設けた減圧手段を介して接続するだけで製造することができるので、製造工程および使用部材を従来と大きく変えることなく製造することができる。

【0034】

また、筐体背面に添設した冷媒タンクより後端部が後方に位置する壁当部材を筐体背面に添設するようにした発明によれば、冷媒タンクは壁当部材より後方に突出することはないので、壁際に設置するときには二元冷凍装置を壁に押し付けても、冷媒タンクが壁に当たって破損することはない。したがって、本発明の二元冷凍装置の設置には細心の注意を払う必要がなく、速やかな設置が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施形態を示す斜視説明図であり、(A)は冷媒タンクを回動していないときの説明図、(B)は冷媒タンクを回動したときの説明図である。

【図 2】

本発明の一実施形態を示す平面説明図であり、(A)は冷媒タンクを回動していないときの説明図、(B)は冷媒タンクを回動したときの説明図である。

【図 3】

本発明の二元冷凍装置の冷媒回路を示す説明図である。

【図 4】

従来の二元冷凍装置の冷媒回路を示す説明図である。


【符号の説明】

- 1 圧縮機
- 2 凝縮器
- 3 減圧弁
- 4 蒸発器
- 5 キャピラリーチューブ
- 6 接続管
- 6 L ループ
- 7 冷媒タンク
- 8 電磁開閉弁
- 9 バイパス管
- 10 制御器
- 11 圧縮機


- 1 2 凝縮器
- 1 3 減圧弁
- 1 4 蒸発器
- 1 5 キャピラリーチューブ
- 1 6 接続管
- 1 7 冷媒タンク
- 5 0 筐体
- 5 1 機器収納部
- 5 2 壁当部材
- 5 3 消音カバー
- 5 4 ヒンジ
- 5 5 タンク搭載部材
- 5 6 止め金具
- 5 7 螺子
- 5 8 回動防止手段
- 5 9 螺子孔
- 6 0 背面扉
- 6 1 被冷却物収納部
- 6 2 扉
- H 高温側冷媒回路
- L 低温側冷媒回路
- 1 0 0、1 0 0 X 二元冷凍装置

【書類名】 図面


【図 1】

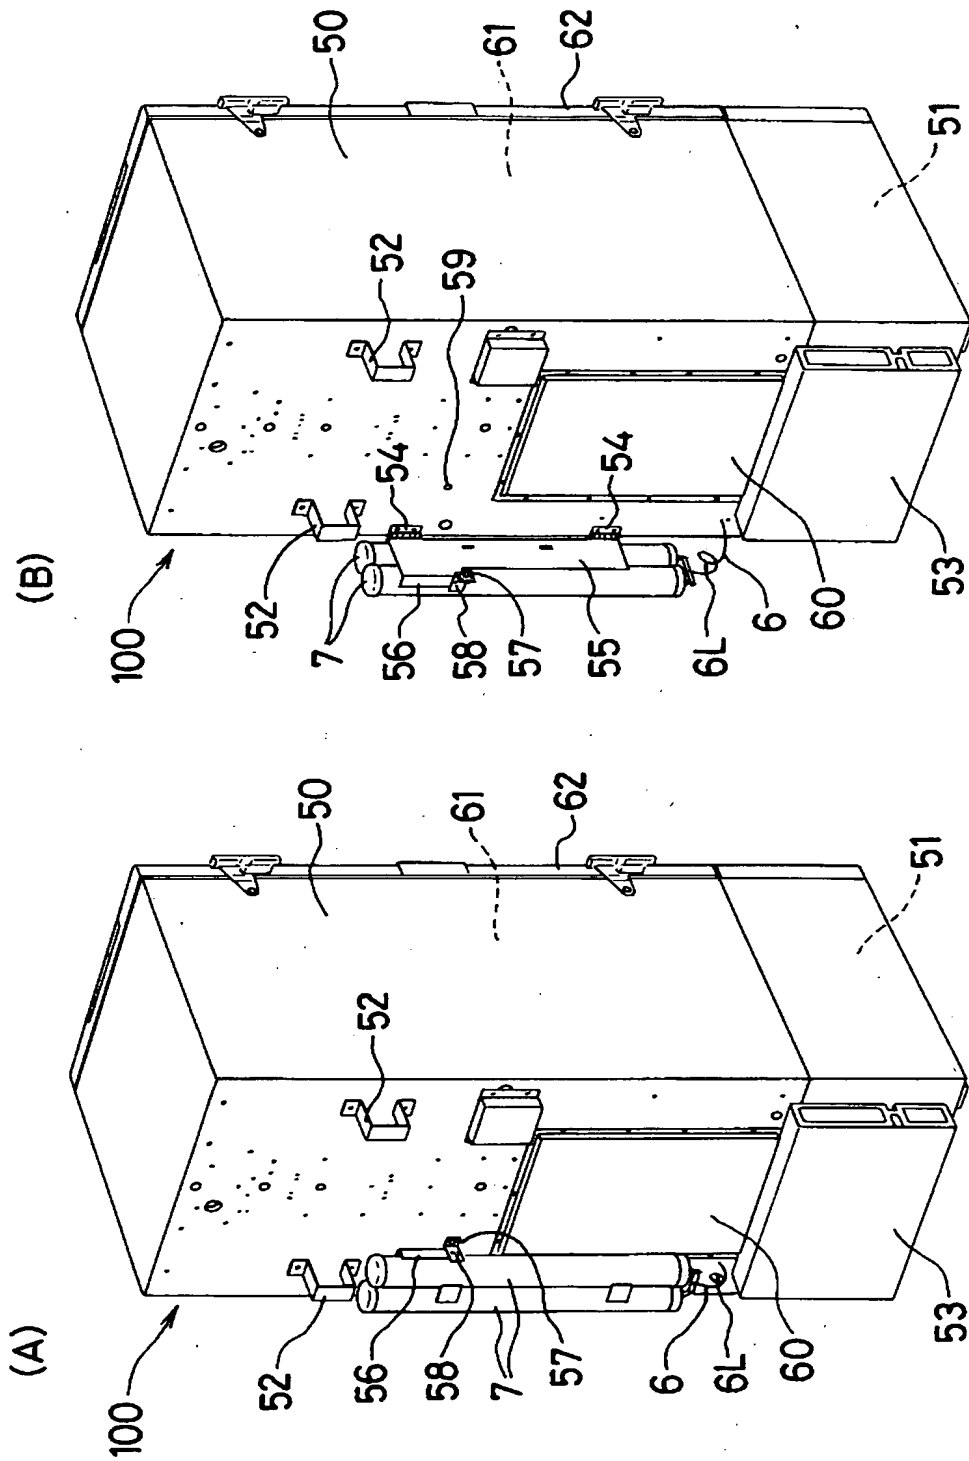


【図 2】

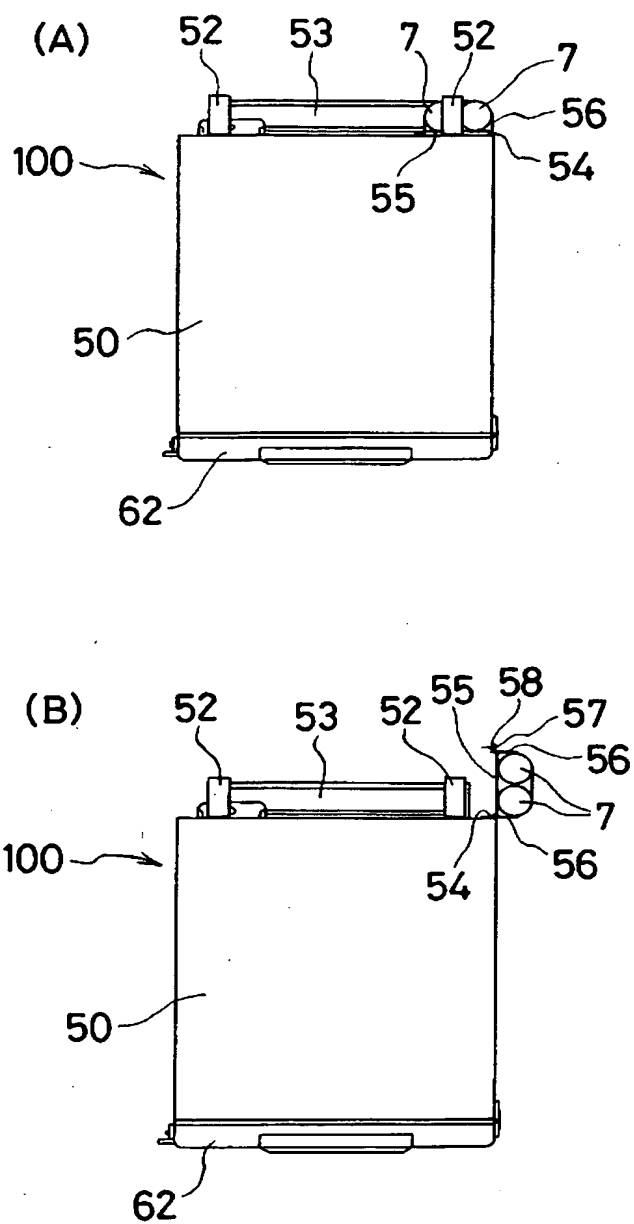

【図 3】

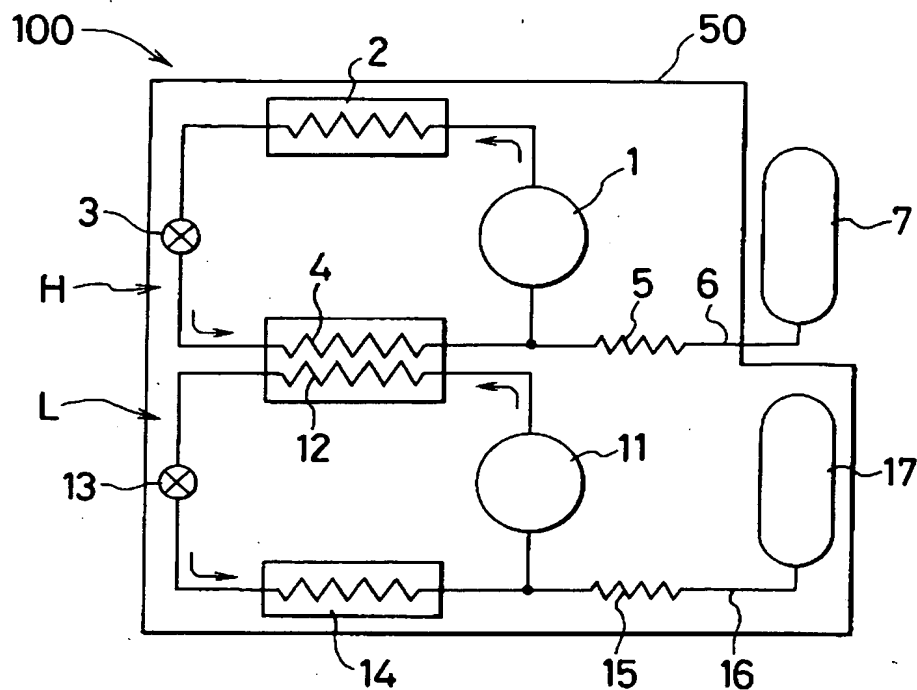

【図 4】

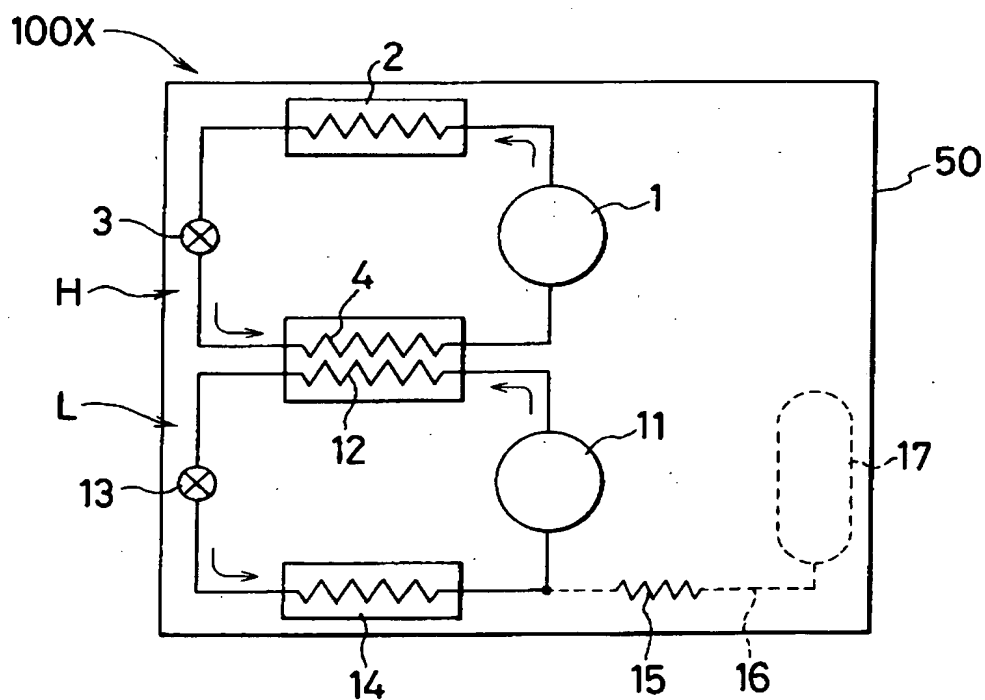

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 圧縮機のモータを小型化して電力消費量と騒音の削減を図ると、冷凍装置の始動性は通常は低下するが、始動性が低下しない構成にした二元冷凍装置を従来と同じ大きさの筐体を用いて製造する。

【解決手段】 筐体 5 0 内に収納する低温側冷媒回路の冷媒凝縮部と高温側冷媒回路の冷媒蒸発部とを併設し、低温側冷媒回路の冷媒凝縮部を高温側冷媒回路の冷媒蒸発部で発生する冷熱により冷却して低温側冷媒回路の冷媒を冷媒凝縮部において凝縮させる二元冷凍装置において、高温側冷媒回路の低圧側に減圧手段を介して接続する高温側の冷媒タンク 7 と低温側冷媒回路の低圧側に減圧手段を介して接続する低温側の冷媒タンク 1 7 とを設け、一方の冷媒タンク、例えば高温側の冷媒タンク 7 を筐体 5 0 の背面に添設し、低温側の冷媒タンク 1 7 を筐体 5 0 の機器収納部 5 1 に設置するようにした。

【選択図】 図 1

特願 2002-347709

出願人履歴情報

識別番号

[000001889]

1. 変更年月日 1990年 8月24日
[変更理由] 新規登録
住 所 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地
氏 名 三洋電機株式会社
2. 変更年月日 1993年10月20日
[変更理由] 住所変更
住 所 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
氏 名 三洋電機株式会社

特願 2 0 0 2 - 3 4 7 7 0 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[3 0 2 0 1 0 4 4 8]

1. 変更年月日

2 0 0 2 年 2 月 1 5 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号

氏 名

三洋電機バイオメディカ株式会社